

hygi.de Produkt-Check

FFP 2 MASKEN

Mit dem hygi.de Produktcheck führen wir für Sie eine Plausibilitätskontrolle des Artikels zur Konformität nach der PSA Verordnung (EU 425/2016) durch. Wir orientieren uns hier an den Herstellerangaben und prüfen folgende Kriterien:

Check 1 1.1	CE- Kennzeichnung Maske Body-Nr. / Zertifikat
Check 2	Prüfstelle zugelassen
Check 3	Klasse + Zusatz
Check 4 4.1 4.2 4.3 4.4	Europäische Norm Nummer/Jahr - Maske EN – Zertifikatsprüfung Echtheit des Zertifikates EU-Konformität
Check 5	Firmenname/Hersteller-hinweis und Produktname
Check 6	Bedienungsanleitung in deutscher Sprache

*Für die Angaben übernehmen wir keine Gewähr

hygi.de GmbH & Co. KG
Postfach 155
D – 48283 Telgte
Tel.: +49-2504-7313-222

hygi.de GmbH & Co. KG
Versandzentrum
Otto-Diehls-Straße 13-17
D - 48291 Telgte
Fax: +49-2504 7313-444

WWW: <http://www.hygi.de/>
E-Mail: info@hygi.de
Steuernummer: 346/5871/1049
USt-IdNr: DE 257 224 517

Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRA 7919
pers. haftende Gesellschafterin: hygi.de Verwaltungs GmbH, Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRB 15134, Geschäftsführer: Christian Bleser, Daniel Bleser

Es gelten die allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der hygi.de GmbH & Co. KG.

Zusammenfassung hygi.de Produktcheck für Artikel:

Atemschutzmaske elasto "Colour" FFP2 NR
 Atemschutzmaske Colour, ohne Ventil, 5-lagig



hygi-Artikel-Nr.: **152523, 152524, 152525, 152526, 152527, 152528, 152529, 152530**

Übersicht	Kriterium	erfüllt	Seite
Check 1 1.1	CE- Kennzeichnung Maske Body-Nr. /Zertifikat	<input checked="" type="checkbox"/>	3 7
Check 2	Prüfstelle zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/>	4
Check 3	Klasse + Zusatz	<input checked="" type="checkbox"/>	5
Check 4		<input checked="" type="checkbox"/>	
4.1	Europäische Norm Nummer/Jahr - Maske		6
4.2	EN – Zertifikatsprüfung		8 & 9
4.3	Echtheit des Zertifikates		10
4.4	EU-Konformität		11
Check 5	Firmenname/Hersteller-hinweis und Produktname	<input checked="" type="checkbox"/>	12
Check 6	Bedienungsanleitung in deutscher Sprache	<input checked="" type="checkbox"/>	13

*Für die Angaben übernehmen wir keine Gewähr

hygi.de GmbH & Co. KG
 Postfach 155
 D – 48283 Telgte
 Tel.: +49-2504-7313-222

hygi.de GmbH & Co. KG
 Versandzentrum
 Otto-Diehls-Straße 13-17
 D - 48291 Telgte
 Fax: +49-2504 7313-444



WWW: <http://www.hygi.de/>
 E-Mail: info@hygi.de
 Steuernummer: 346/5871/1049
 USt-IdNr: DE 257 224 517

Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRA 7919
 pers. haftende Gesellschafterin: hygi.de Verwaltungs GmbH, Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRB 15134, Geschäftsführer: Christian Bleser, Daniel Bleser

Es gelten die allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der hygi.de GmbH & Co. KG.

Check 1 – CE-Kennzeichnung

Atemschutzmaske elasto “Colour” FFP2 NR CE 2233

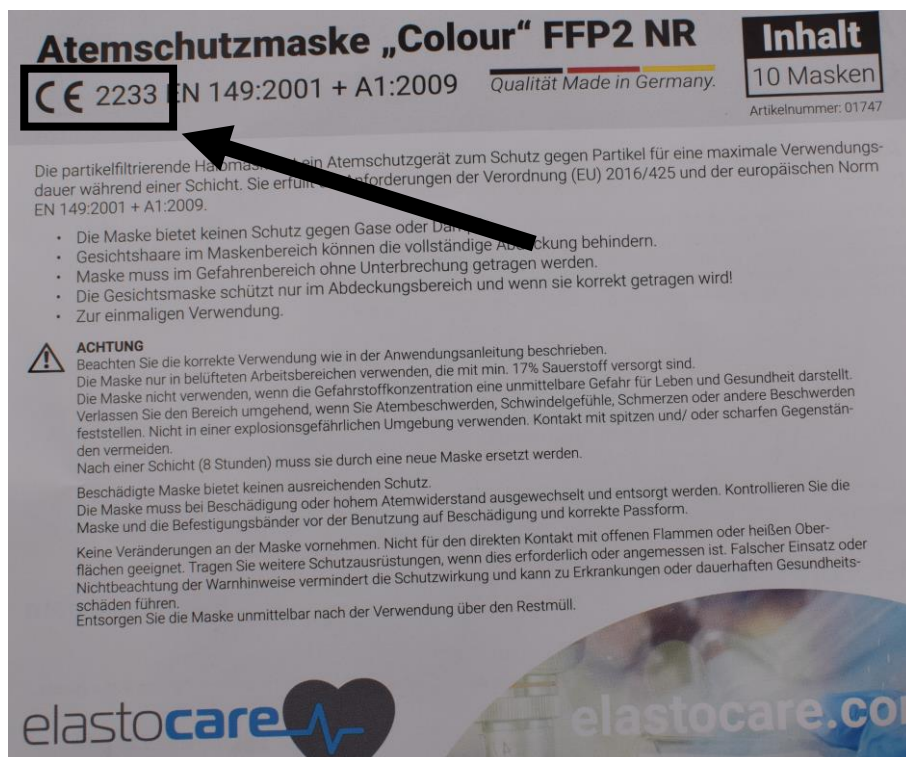

Check 1 – CE-Kennzeichnung = CE 2233

- auf dem Produkt enthalten
- auf der Verpackung enthalten





Check 2 – Prüfstelle

Atemschutzmaske elasto “Colour” FFP2 NR CE 2233

Check 2 – Prüfstelle zugelassen

Commission and its priorities | **Policies, information and services**

 English 

European Commission > Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs > Single Market and Standards > Tools and Databases > Notified bodies Nando > Body

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Home | **Single Market and Standards** | Industry | Entrepreneurship and SMEs | Access to finance for SMEs | Sectors

Notified bodies Nando Found : 1

Country
Legislation
Body
Construction products
Free search
Mutual Recognition Agreements
Protocol on Ireland/Northern Ireland
CETA Protocol on Conformity Assessment
Notifying Authority - Notification procedures
Accreditation Body
Glossary

Notification

Body :
GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft.
Jablonka u. 79,
1037 Budapest
Country : Hungary

Phone : +36 1 250 3531
Fax : +36 1 250 3531

Email : gepteszt@gepteszt.hu
Website : www.gepteszt.hu

Notified Body number : 2233

Last approval date : 13/04/2010

Legislations


• [Regulation \(EU\) 2016/425 Personal protective equipment](#) [HTML](#) [PDF](#)

Link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F166341

Stand: 19.08.2021

Check 3 – Klasse

Atemschutzmaske elasto “Colour” FFP2 NR CE 2233




Check 3 – Klasse: FFP2 + Zusatz vorhanden

Zusatz: NR = nur für eine Arbeitsschicht

Check 4 – Europäische Norm

4.1 - Nummer und Jahr auf der Maske

Atemschutzmaske elasto "Colour" FFP2 NR CE 2233
EN149:2001+A1:2009



Check 4 – Nummer und Jahr der Veröffentlichung der EUROPÄISCHEN NORM: EN 149:2001 + A1:2009 ✓

wird auf Seite 8 und 9 im Zertifikat angezeigt



Check 1 - CE Kennzeichnung

1.1 - NB 2233 PSA Konformität mit Zertifikat

Jablónka St. 79. 1037 Budapest HUNGARY	Tel: +36-1 / 250-35-31 Fax: +36-1 / 430-08-88	E-mail: gepteszt@gepteszt.hu web: www.gepteszt.hu	
--	--	---	---

GÉPTESZT Kft. Inspection Body

Notified Body under regulation
2016/425 (EU) personal protective equipment
Notified Body number in the EU on n°2233
Registration number: 3/2018

C E R T I F I C A T E

of conformity to type assessment based on internal production control plus supervised
product checks at random intervals (module C2)

N° ED29/E274/2106/E/2233

Requirement: fulfillment of Article 19 c.) i. point of the regulation 2016/425 EU in
accordance with Annex VII, module C2 conformity to type assessment

Name of manufacturer (controlled):

elasto GmbH & Co. KG

Address: Franz-Sollfrank-Str. 6., D-92237 Sulzbach-Rosenberg, GERMANY

The above mentioned company is authorized to affix marking

CE 2233

on the personal protective equipment listed in Annex 1 of the certificate

Type of inspection: module C2

Method used during inspection:
On-site production control according to regulation 2016/425 module C2 and relevant RFU
sheets. Supervised product checks according to the harmonised standards.

GÉPTESZT KFT.
EVE Ellenőrző Szervezet
NB 2233
1037 Budapest, Jablónka u. 79.


Hajdu Márton
Head of the Inspection Body

2021.06.16. issue date	2021.12.31. expiry date
---------------------------	----------------------------

Check 4 – Europäische Norm

4.2 - Nummer und Jahr auf dem Zertifikat stimmen mit der Maskenbedruckung überein

GÉPTESZT N°.: TD11/GT362/345/2106/E/2233

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Name of Certification Body: **GÉPTESZT Kft.** Phone: +3612503531
 EU notified body identification number: **2233** Fax: +3614300888
 Address: **Jablonka St. 79, 1037 Budapest, HUNGARY** E-mail: **gepteszt@gepteszt.hu**

Present EU type-examination certificate is valid only with the sealed identification sample (authentic sample) and the documents identified below. The EU type-examination certificate is not transferable.

1. Product designation: **Particle filtering half mask**
Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR FFP2 non reusable particle filtering half mask without valves.
 Serial / Model No.: **01747 Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR**
 Year of production: **2021**

2. Name and address of the holder of the certificate (Manufacturer or authorized representative):
elasto GmbH & Co. KG
 Address: **Franz-Sollfrank-Str. 6, D-92237 Sulzbach-Rosenberg, GERMANY**

4. Protecting ability of PPE. Personal protective equipment providing respiratory system protection.
 Category III, EN 149:2001+A1:2009 class **FFP2 NR**

5. Identification data of the records of examination for compliance of PPE:
 a. Certification Body: **GÉPTESZT Kft.**
 Record of examination: **VD35/362/2106/E/2233**
 b. Identification of body: **NB2233**

6. Documentation of the compliance with the essential health and safety protection requirements:
 Fully applied nationalized standard(s) during the production of the PPE:
 Category III, EN 149:2001+A1:2009 class **FFP2 NR**

- Users information
- Technical file

7. **CE** Requirements for indicating the CE mark: The size of the CE marking may not be less than 5 mm. The CE mark must be located on the product label

8. Further notes relating to the PPE: Manufacturer cannot place on the market or bring into service any Category III PPE without having established a formal agreement with a Notified Body about conformity to type assessment.

The EU type-examination certificate will be withdrawn in case of existence of conditions stated in Article 32 point 5. and in Annex V. 7.7. of regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament of the Council.

Legal remedy can be applied against the condition stated in the EU type-examination Certificate. The application for appeal should be submitted to the Director Manager of GÉPTESZT Kft., and the application will be judged by the board of GÉPTESZT Kft. Certificate Body.


The type tested complies with the regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament of the Council.

The present certificate is valid until 16th June, 2026

Budapest, 16th June, 2021- HUNGARY

GÉPTESZT Kft.
 EVE Tanulmányi Szervezet
 NB 2233
 1037 Budapest, Jablonka u. 79.

 Budai István
 Head of Certification Body



Check 4 – Europäische Norm

4.2 - Nummer und Jahr auf dem Zertifikat stimmen mit der Maskenbedruckung überein

EU – Konformität als Schutzmaske

DIN EN 149:2001+A1:2009 (Deutsche Fassung)
(EU) 2016/425 Annex 9

Seite 2 des CE -PSA-Zertifikates

Detailansicht

e. Protecting ability of PPE, personal protective equipment providing respiratory system protection.
Category III, EN 149:2001+A1:2009 class FFP2 NR

5. Identification data of the records of examination for compliance of PPE:


- a. Certification Body: GÉPTESZT Kft.
Record of examination: VD35/362/2106/E/2233
- b. Identification of body: NB2233

6. Documentation of the compliance with the essential health and safety protection requirements:

Fully applied nationalized standard(s) during the production of the PPE:
Category III, EN 149:2001+A1:2009 class FFP2 NR

Annexes:

- Users information
- Technical file

7.  Requirements for indicating the CE mark: The size of the CE marking may not be less than 5 mm. The CE mark must be located on the product label


8. Further notes relating to the PPE: Manufacturer cannot place on the market or bring into service any Category III PPE without having established a formal agreement with a Notified Body about conformity to type assessment.

The EU type-examination certificate will be withdrawn in case of existence of conditions stated in Article 32 point 5, and in Annex V, 7.7. of regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament of the Council.

CHECK 4

Check 4 – Europäische Norm

4.3 – Echtheit des Zertifikates TD11/GT362/345/2106/E/2233 ist bestätigt



Certificate checker

Certificate checker Services About Us Contact Magyar English

Certificate checker

In some cases due to possible extensions, the original certificate could not be found in our system as it is withdrawn.

You can check the current valid certificate of a product either with the manufacturer and model number, or with the first three part of the certificate number (e.g. TD11/GT000/000).

If you do not get any results in this way, please contact us at nb2233@gepteszt.hu

Certificate number:

Or

Manufacturer:

and model:

Search

Results:

Certification number: TD11/GT362/345/2106/E/2233
Manufacturer/Holder: Elasto GmbH & Co. KG
Model: Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR
Description: particle filtering half mask
Standard/scope: EN:149:2001+A1:2009
Date of issue: 2021-06-16
Expiry date: 2026-06-16

Copyright © 2021 Gépteszt Ltd.
[Contact](#)

CHECK 4 


[Link:http://gepteszt.hu/certificate-checker/](http://gepteszt.hu/certificate-checker/)

Check 4 – Europäische Norm

4.4 – Unternehmen bestätigt EU Konformität
EUROPÄISCHEN NORM: EN 149:2001 + A1:2009

EU – Konformität als Schutzmaske

DIN EN 149:2001+A1:2009 (Deutsche Fassung)
(EU) 2016/425 Annex 9





PROMOTION FOR LIFE

Konformitätserklärung/ Declaration of conformity

Hiermit erklären wir/ *We hereby declare:*
 elasto GmbH & Co. KG
 Franz-Sollfrank-Straße 6
 92237 Sulzbach-Rosenberg

dass folgender Artikel/ *the following article:*

01747 Atemschutzmaske/ *Respiratory mask „Colour“ FFP2 NR*

mit den Vorschriften folgender Verordnung übereinstimmt/ *complies with the following regulation:*
2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung/ *to personal protective equipment*

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller elasto GmbH & Co. KG/ *This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer elasto GmbH & Co. KG.*


Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der oben aufgeführten EU-Verordnung wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Norm/ *The accordance of the listed product with the EU regulation is proved by the entire observance of the following standard:*

EN 149:2001+A1:2009 (DIN EN 149:2009-08)

Die notifizierte Stelle/ *The notified body: GÉPTESZT Termelőeszközök Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., Jablonka u. 79., 1037 Budapest, Hungary, (Notified Body No. 2233), hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und überwacht die Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2)/ *has done the type examination (modul B) and monitors the conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Modul C2).**

EU-Baumusterprüfbescheinigung/ *type examination certificat: TD11/GT362/345/2106/E/2233*

Ort/ *city:* Sulzbach-Rosenberg
 Datum/ *date:* 16.06.2021



Unterschrift/ *signature:* Frank Sperber (Geschäftsleitung/ *Director*)


CHECK 4



11

Check 5 – Bezeichnung Hersteller

Atemschutzmaske elasto “Colour” FFP2 NR



Check 5 – Firmennamen oder Herstellerhinweis, Produktname

Hersteller: elasto GmbH & Co. KG

Produktname: elasto “Colour”



Check 6 – Bedienungsanleitung

Atemschutzmaske elasto "Colour" FFP2 NR

Atemschutzmaske „Colour“ FFP2 NR

CE 2233 EN 149:2001 + A1:2009

Qualität Made in Germany.

Inhalt

10 Masken

Artikelnummer: 01747

Anwendungsanleitung.

Hände vor dem Anlegen und nach dem Abnehmen gründlich waschen.

Halten Sie die Maske an den Bändern so, dass der Nasenbügel nach oben zeigt und biegen Sie ihn gerade. Drehen Sie die Maske so, dass Sie in den nach innen gewölbten Teil schauen können. Nehmen Sie die Maske an den Bändern und platzieren Sie sie über die Ohren, Mund und Nase. Berührungen der äußeren und inneren Maskenfläche möglichst vermeiden.




Passen Sie den Nasenbügel der Maske mit der Hand dem Nasenrücken an. Platzieren Sie diese am Kinn, sodass sie bequem sitzt. Testen Sie den korrekten Sitz: Beim Einatmen dürfen keine Luftströme am Maskenrand wahrnehmbar sein. Korrigieren Sie den Sitz wenn notwendig. Sollte ein dichtes Anliegen der Maske nicht erreichbar sein, darf der Bereich, in dem eine Atemschutzmaske getragen werden muss, nicht betreten werden.

Die Konformitätserklärung entnehmen Sie bitte der elasto Website (elasto.de) unter der o.g. Artikelnummer unter dem Feld „Hinweis“.
Notifizierte Stelle: GÉPTESZT Termelőeszközökét Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., Jablonka u. 79., 1037 Budapest, Hungary (2233)



elastocare.com


 Anleitung vor der Inbetriebnahme lesen und aufbewahren.




Nicht wiederverwendbar.

Hersteller:
elasto GmbH & Co. KG
Franz-Sollfrank-Straße 6
D-92237 Sulzbach-Rosenberg, Germany

Dunkel lagern und vor UV- und Sonnenlicht schützen
Haltbarkeit: 2 Jahre.

Luftfeuchtigkeit:  max. 65%

Temperatur:  5°C - 40°C

Check 6 – Bedienungsanleitung in deutscher Sprache als Download Datei Produktname: elasto "Colour" 